Guia passo-a-passo do Allon®

FUNCIONAMENTO PASSO-A-PASSO DO ALLON®: Modo de normotermia (predefinição)

Indicações de utilização: mantenha a temperatura corporal predefinida, conforme determinado pelo médico. Mantenha a temperatura corporal normal durante os procedimentos cirúrgicos em pacientes adultos e pediátricos.

1. CONFIGURAÇÃO

1.	Coloque a unidade Allon no local pretendido e trave as rodas da frente.	
2.	Encha o depósito de água de forma que o nível se situe entre as duas linhas vermelhas utilizando apenas **água da torneira filtrada por 0,22 mícrones ou esterilizada.**	
3.	Coloque o ThermoWrap® apropriado na mesa operatória *(consulte as Instruções de utilização do ThermoWrap).*	
4.	Ligue os tubos de água ao ThermoWrap e ao dispositivo Allon, ouvindo o som de um clique à medida que cada tubo é ligado. Assegure-se de que os grampos no ThermoWrap estão abertos.	
5.	Ligue o dispositivo Allon em **Ligar**. É realizado um teste automático completo.	
6.	O pré-aquecimento da água é realizado automaticamente após o teste automático.	
7.	Depois de concluído, o sistema começa automaticamente a fluir água quente para o ThermoWrap.	
8.	Pode selecionar a Set-Point Temperature (Temperatura do ponto definido) (ponto definido predefinido = 37,0 °C no modo de normotermia) ou a Water Out Temperature (Temperatura da saída de água) no modo manual (predefinição = 38,5 °C) utilizando a tecla Set Point (Definir ponto).	
9.	Certifique-se de que os alarmes do dispositivo estão ligados em **Ligar**. Se surgir a seguinte mensagem na parte inferior do ecrã: «Alarmes de sensores temp. **desligados**», siga estes passos para ligar novamente os alarmes. Aceda a **MENU**, selecione **SETTINGS**, introduza a palavra-passe **6873**, selecione « Temp Sensor Alarms » — **Ligar** e, depois, prima **OK** para confirmar a seleção.	

2. AQUECIMENTO

1.	Posicione o paciente no ThermoWrap (após o envolvimento se ter enchido com água). Consulte as Instruções de utilização do ThermoWrap.	
2.	Ligue o cabo **Núcleo** à tomada **Core** localizada à direita e o cabo **Superfície** à tomada **Surface** localizada à esquerda do sistema, combinando as cores, cinzento com cinzento e verde com verde, e depois, ligue as sondas de temperatura aos cabos adaptadores apropriados.	
3.	Insira a sonda **Núcleo** no paciente e fixe a sonda **Superfície** na pele do paciente.	
4.	Fixe o ThermoWrap no paciente.	
5.	• No modo de normotermia, a temperatura do paciente é agora regulada pelo Allon, conforme definido pelo médico. • No modo manual, a temperatura da água é agora regulada pelo Allon, conforme definido pelo médico.	

**Este documento não substitui a necessidade da leitura de todo o Manual do utilizador do Allon.*

3. ARREFECIMENTO

1.	Ao arrefecer o paciente, o Allon deve ser colocado no modo de espera.
2.	Selecione **Modo de espera** a partir do menu e mantenha este modo até que o médico queira que a máquina aqueça.
3.	Para retomar o aquecimento com o Allon, selecione **Funcionamento** a partir do menu.

4. DESLIGAR

1.	Mude para o modo de espera e aguarde alguns segundos.
2.	Encerre os conectores firmemente no ThermoWrap, desembrulhe o paciente e remova as sondas do paciente.
3.	Desligue o ThermoWrap do Allon.
4.	Elimine o ThermoWrap e as sondas descartáveis.

5. CUIDADOS APÓS A UTILIZAÇÃO: LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA LIMPEZA E DESINFEÇÃO

1.	Deite pastilhas ou pó de dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) no depósito de água de acordo com as recomendações do fabricante de NaDCC e deixe atuar durante 30 minutos no modo de espera.
2.	Esvazie o depósito de água: selecione **Esvaziar** a partir do menu Serviços (consulte o Manual do utilizador para obter instruções). O Allon irá alertá-lo quando o depósito estiver vazio. • **Para uma utilização frequente (3 a 4 vezes por semana):** uma vez por semana, drene a água e enxague com água filtrada por 0,22 mícrones ou esterilizada. • **Para uma utilização pouco frequente:** após cada utilização, drene a água e enxague com água filtrada por 0,22 mícrones ou esterilizada.
3.	Limpe e desinfete a máquina e os acessórios de acordo com o protocolo do hospital. Utilize toalhetes de desinfeção padrão para desinfetar as superfícies externas do sistema Allon, incluindo todos os cabos de temperatura, ligações de água e conectores, bem como o conjunto de tampa, corrente e anel de ancoragem.

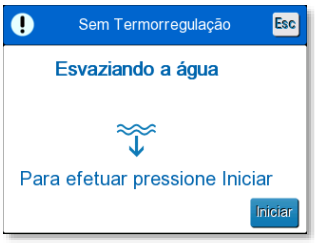

4. TINHA CONHECIMENTO DISTO?

1.	A utilização do ThermoWrap **NÃO** substitui as linhas de orientação de práticas comuns para prevenção de úlceras de pressão. Continue a utilizar as medidas preventivas padrão para úlceras de pressão quando utilizar o ThermoWrap.
2.	O ThermoWrap **NÃO** deve ser utilizado como ferramenta para levantar ou mover o paciente.
3.	Evite a acumulação de fluidos entre a pele e o ThermoWrap.

BELMONT MEDICAL TECHNOLOGIES

780 BOSTON ROAD
BILLERICA, MA 01821 EUA
Tel.: 866.663.0212

WWW.BELMONTMEDTECH.COM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

EUA: 855.397.4547
GLOBAL: +1.978.663.0212

TECHSUPPORT@BELMONTMEDTECH.COM